

AND

Digital Blood Pressure Monitor

Model UA-705

Instruction Manual
Original

ENGLISH

Manuel d'instructions
Traduction

FRANÇAIS

Manual de Instrucciones
Traducción

ESPAÑOL

Manuale di Istruzioni
Traduzione

ITALIANO

使用手冊
翻譯

中文

1WMPD4000988D

Sommaires

Chers Clients	1
Remarques Préliminaires.....	1
Précautions.....	2
Nomenclature	3
Symboles	4
Utilisation de l'appareil	5
Mise en place/ Remplacement de la pile	5
Branchement du tuyau d'air.....	5
Sélection correcte du brassard.....	6
Mise en place du brassard	7
Comment faire des mesures correctes	7
Mesure (Opération).....	7
Après la mesure.....	7
La Mesure.....	8
Mesures avec l'enregistrement des données	8
Consignes et observations pour une mesure correcte	9
Mode Opérateur.....	10
Indicateur de la Classification de la Pression Sanguine Suivant l'OMS	10
Indicateur du Progrès de la Pression	10
Qu'est-ce Qu'une Fréquence Cardiaque Irrégulière?.....	11
Pression Sanguine.....	11
Qu'est-ce que la pression sanguine?.....	11
Qu'est-ce que l'hypertension et comment la contrôler?	11
Comment mesurer la pression sanguine chez soi?	11
Classification de la pression sanguine suivant l'OMS.....	12
Variation de la pression sanguine	12
Recherche des Pannes.....	13
Entretien	13
Fiche Technique.....	14

Chers Clients

Félicitations pour l'achat de ce moniteur de la pression sanguine A&D dernier cri, un des moniteurs les plus avancés disponibles aujourd'hui. Etant étudié pour faciliter l'utilisation et la précision, ce moniteur vous donnera au quotidien des mesures précises de la pression sanguine.

Lisez ce manuel entièrement et soigneusement avant d'utiliser l'appareil pour la première fois.

Remarques Préliminaires

- Cet appareil est conforme à la directive européenne 93/42 EEC des appareils médicaux avec le marquage **CE**₀₁₂₃ de conformité. (0123: Le numéro de référence au corps notifié concerné)
- Cet appareil est conçu pour tous à l'exception des nouveaux nés et des enfants.
- Lieu d'utilisation:
Cet appareil est destiné à une utilisation dans un environnement domestique de soins de santé.

- Cet appareil est conçu pour mesurer la tension artérielle et la fréquence cardiaque des personnes dans un objectif de diagnostic.

Précautions


- Cet appareil est équipé de pièces de précision. C'est pourquoi il faut éviter de l'exposer à de fortes températures, à une humidité extrême ou au soleil. De même, il faut éviter les chocs et le protéger de la poussière.
- Nettoyez l'appareil et le brassard avec un chiffon doux et sec, ou un chiffon légèrement humidifié avec de l'eau et un détergent neutre. N'utilisez jamais d'alcool, du benzène, de diluant ou autres produits chimiques pour nettoyer l'appareil ou le brassard.
- Évitez de tordre le brassard ou de laisser le tuyau trop plié pendant de longues périodes ce qui pourraient avoir une influence néfaste sur la durée de vie des pièces.
- L'appareil et le brassard ne sont pas imperméables. Évitez de les mouiller avec de l'eau, de la transpiration ou la pluie.
- Les mesures peuvent être faussées si l'appareil est utilisé près d'un poste de télévision, un four à micro ondes, un téléphone cellulaire, des appareils à rayon X ou tout autre appareil dégageant de forts champs électriques.
- L'appareil usé, les pièces et les piles ne doivent pas être jetés comme les déchets ménagers ordinaires, ils doivent être traités conformément à la législation en vigueur.
- Lorsque vous utilisez l'adaptateur secteur, assurez-vous qu'il peut être facilement retiré de la prise électrique si nécessaire.
- Lorsque vous réutilisez l'appareil, vérifiez qu'il est propre.
- Ne modifiez pas l'appareil. Cela pourrait l'endommager ou provoquer des accidents.
- Pour mesurer la tension artérielle, le bras doit être suffisamment pressé par le brassard afin de bloquer temporairement la circulation sanguine dans l'artère. Cela peut provoquer une douleur, un engourdissement ou une marque rouge temporaire sur le bras. Cet état survient particulièrement si la mesure est répétée de manière successive.
Les douleurs, les engourdissements ou les marques rouges disparaissent avec le temps.

Contre-indications


Vous trouverez ci-après des précautions destinées à l'utilisation appropriée de l'appareil.

- N'appliquez pas le brassard sur un bras sur lequel un autre équipement médical électrique est fixé. L'équipement pourrait ne pas fonctionner correctement.
- Les personnes victimes d'une insuffisance circulatoire grave au niveau du bras doivent consulter un médecin avant d'utiliser l'appareil afin d'éviter tout problème médical.
- N'effectuez pas vous-même de diagnostic des résultats de la mesure et ne commencez pas de traitement vous-même. Consultez toujours votre médecin pour une évaluation des résultats et du traitement.
- N'appliquez pas le brassard sur un bras portant une blessure non guérie.
- N'appliquez pas le brassard sur un bras recevant un goutte-à-goutte intraveineux ou une transfusion sanguine. Cela pourrait provoquer des blessures ou des accidents.
- N'utilisez pas l'appareil en présence de gaz inflammables tels que des gaz anesthésiants. Cela pourrait provoquer une explosion.
- N'utilisez pas l'appareil dans des environnements à forte concentration d'oxygène, tels qu'une chambre à oxygène sous haute pression ou une tente à oxygène. Cela pourrait provoquer un incendie ou une explosion.


Nomenclature

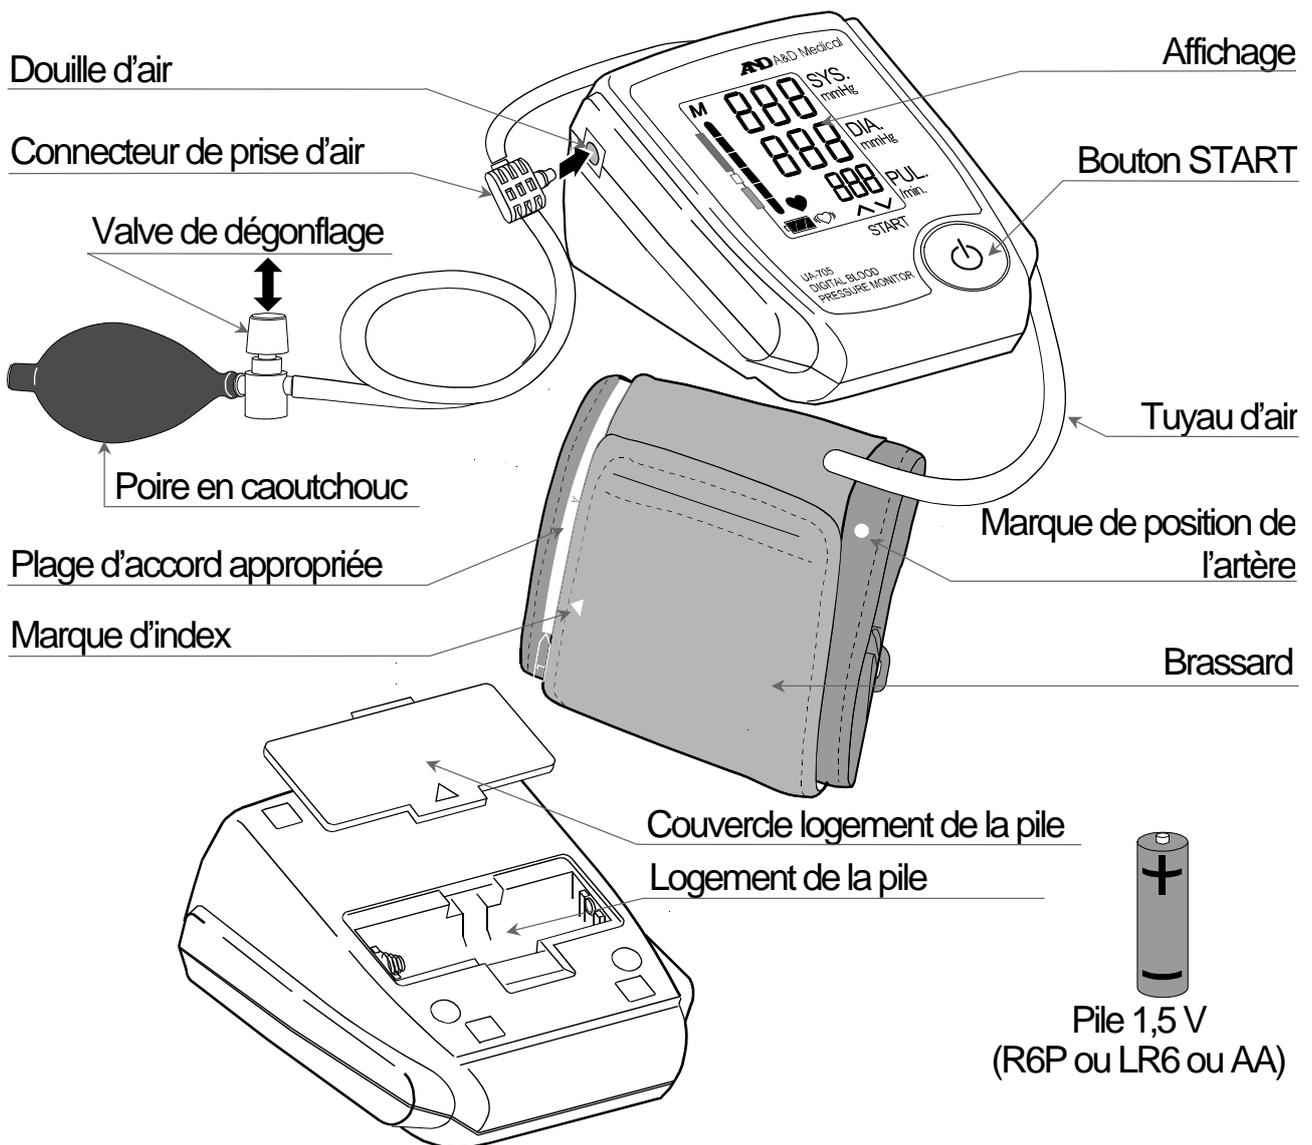

Ecran d'affichage

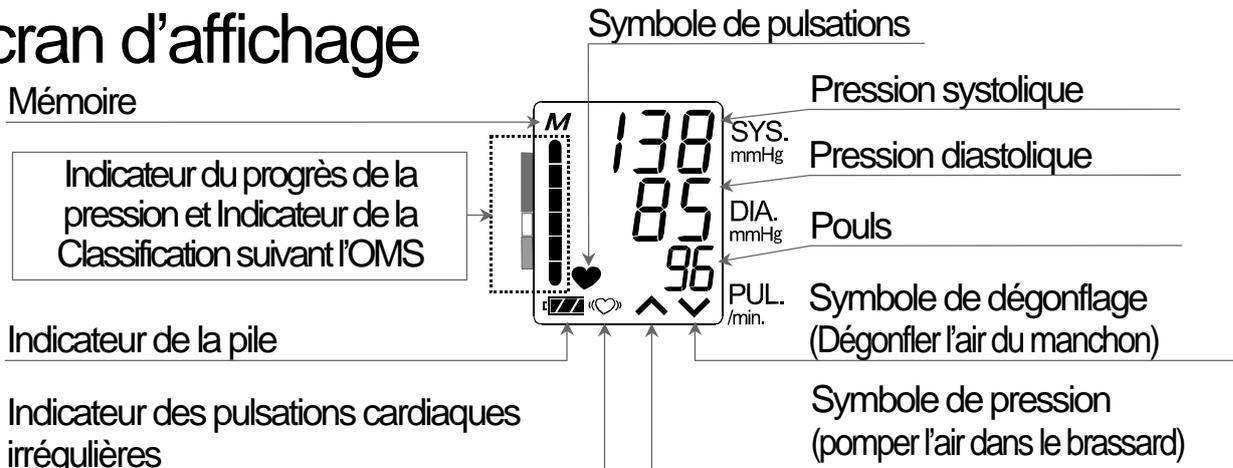

Symboles

Symboles	Fonction / Signification	Actions correctives
	Interrupteur pour éteindre et allumer l'appareil	_____
	Repères pour installer la pile	_____
	Type BF: L'appareil, le brassard et les tubes isolants ont été conçus de manière à fournir une protection particulière contre les électrochocs.	_____
	Cet indicateur apparaît lorsque la mesure est en cours. Il clignote quand les pulsations cardiaques sont détectées.	L'appareil est en train de mesurer; restez calme.
	Cet indicateur apparaît lorsque des pulsations cardiaques irrégulières (arythmies) ou que d'autres mouvements de corps excessifs sont détectés pendant la mesure.	_____
	Clignote quand il y a de l'air restant dans le brassard. Clignote à l'achèvement de la mesure jusqu'à ce que le dégonflage soit accompli.	Appuyer sur le bouton de la valve de dégonflage pour dégonfler l'air du brassard.
	Clignote quand la pression est insuffisante pour la mesure.	Pomper l'air dans le brassard avec la poire en caoutchouc.
	Les mesures précédentes conservées dans la MEMOIRE de chaque bouton.	_____
 Full Battery	L'indicateur de la tension de la pile pendant la mesure.	_____
 low Battery	La tension de la pile est faible quand il clignote.	Changer la pile par une neuve.
	Apparaît en cas de fluctuation de la pression due à un mouvement pendant la mesure.	Recommencez la mesure. Restez parfaitement tranquille pendant la mesure.
	Apparaît si la différence entre la pression systolique (tension maxima) et la pression diastolique (tension minima) est inférieure à 10 mmHg. Apparaît lorsque la pression n'augmente pas pendant le gonflage du brassard.	Vérifiez le tuyau d'air, le connecteur de prise d'air. Attachez le brassard correctement, et recommencez la mesure.
	Apparaît lorsque le brassard n'est pas attaché correctement.	Vérifiez le tuyau d'air, le connecteur de prise d'air. Attachez le brassard correctement, et recommencez la mesure.
 PUL DISPLAY ERROR	La pression n'est pas détectée correctement.	
	Label des appareils médicaux conformes à la directive européenne.	_____
	Représentant UE	_____
	Fabricant	_____
	Date de fabrication	_____

Symboles	Fonction / Signification	Actions correctives
	Marquage WEEE	_____
	Refer to instruction manual/booklet	_____
SN	Numéro de série	_____


Utilisation de l'appareil

Mise en place/ Remplacement de la pile

1. Enlevez le couvercle de la pile.
2. Insérez une nouvelle pile dans le compartiment de pile comme indiqué, en prenant garde que la polarité (+) et (-) soit correcte.

Utilisez seulement la pile R6P, LR6, AA ou celle équivalente.

3. Fermez le couvercle de la pile.

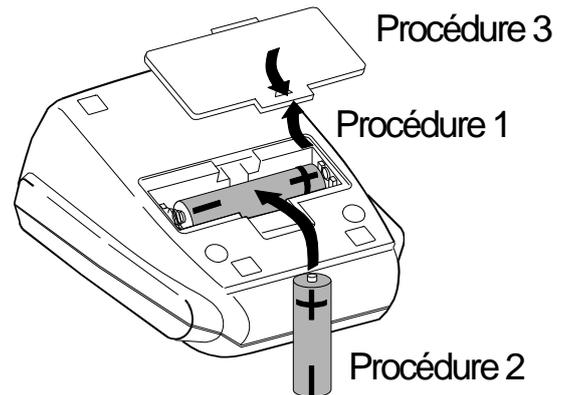


ATTENTION

- Insérer la pile comme indiqué dans le logement de la pile. Sinon, l'appareil ne fonctionnera pas.
- Quand  (marque de pile faible) clignote dans l'affichage, changer la pile par une neuve.
-  (symbole de pile faible) n'apparaît pas quand la pile est épuisée.
- La durée de vie de la pile varie en fonction de la température ambiante et peut être plus courte aux températures basses.
- Utiliser seulement la pile spécifiée. La pile fournie avec l'appareil est pour vérifier la performance du moniteur et peut avoir une durée de vie limitée.
- Enlever la pile si l'appareil ne doit pas être utilisé pendant un long moment. La pile peut avoir une fuite et causer un mauvais fonctionnement.
- Les données enregistrées sont effacées lorsque la pile est enlevée.

Branchement du tuyau d'air

Insérez fermement le connecteur de prise d'air dans la douille d'air.

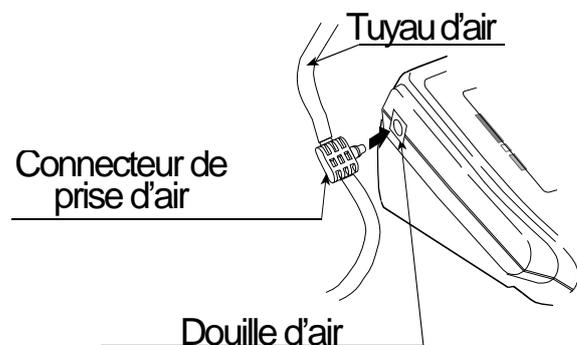

Utilisation de l'appareil

Sélection correcte du brassard

L'emploi d'une taille correcte du brassard est important pour la lecture précise. Si le brassard n'est pas à la taille appropriée, la lecture peut donner une valeur incorrecte de la pression sanguine.

- La mesure de bras est imprimée sur chaque brassard.
- L'index ▲ et la plage d'accord appropriée sur le brassard vous indiquent si vous mettez le brassard correctement. (Voir "**Mise en place du brassard**" à la page prochaine.)
- Si l'index ▲ se trouve en dehors de la plage, prière de prendre contact avec votre revendeur local afin d'acheter le brassard pour le remplacement.
- Le brassard est un produit consommable. S'il est usé, achetez-en un neuf.

Taille du bras	Taille du brassard recommandée	Commande No.
32cm à 45cm	Brassard adulte de grande taille	CUF-D-LA
22cm à 32cm	Brassard adulte	CUF-D-A

Taille du bras: La circonférence du biceps.

Note: Le modèle UA-705 n'est pas conçu pour utiliser un brassard pour adulte de petite taille.

Symboles imprimés sur le brassard

Symbols	Function / Meaning	Recommended Action
●	Marque de position de l'artère	Réglez la marque ● sur l'artère du bras supérieur ou alignez-la sur l'annulaire sur l'intérieur du bras.
▲	Index	_____
REF	Numéro du catalogue	_____
A	Plage d'ajustement appropriée pour le brassard adulte. Imprimé sur le brassard adulte.	_____
L	Plage d'utilisation du brassard adulte de grande taille. Plage supérieure imprimée sur le brassard adulte.	Utilisez le brassard adulte de grande taille au lieu du brassard adulte.
L	Plage d'ajustement appropriée pour le brassard adulte de grande taille. Imprimé sur le brassard adulte de grande taille.	_____
S	Plage inférieure imprimée sur le brassard adulte.	_____
A	Plage d'utilisation du brassard adulte. Imprimé sur le brassard adulte de grande taille.	Utilisez le brassard adulte au lieu du brassard adulte de grande taille.
LOT	Numéro de lot	_____

Brassard adulte de grande taille

Plage d'accord appropriée



Brassard adulte


Plage d'accord appropriée



Utilisation de l'appareil

Mise en place du brassard

1. Enroulez le brassard autour du bras, à 1 ou 2 cm au-dessus du coude, comme indiqué sur l'illustration ci-contre. Placez le brassard directement sur la peau, car un vêtement pourrait assourdir la pulsation et provoquer une erreur de mesure.
2. Evitez également de remonter la manche, car elle comprimerait le bras ce qui pourrait aussi provoquer une erreur de mesure.
3. Confirmez que l'index ▲ se trouve à l'intérieur de la plage d'accord appropriée.

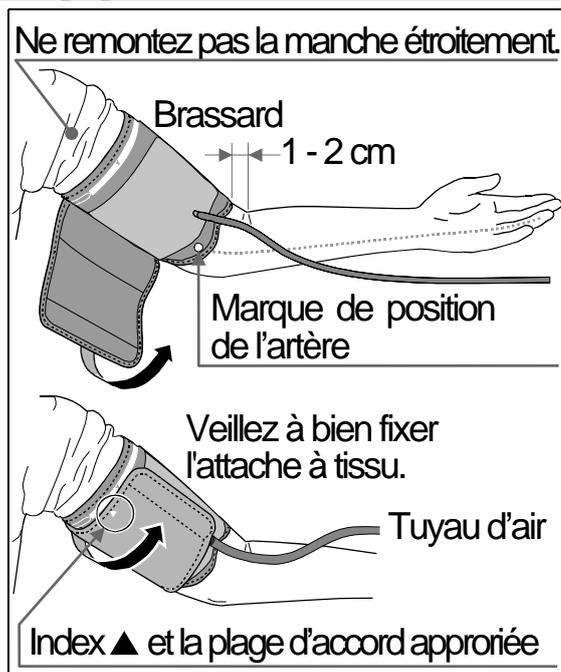

Comment faire des mesures correctes

Pour une meilleure précision des mesures de la pression sanguine :

- Asseyez-vous confortablement sur une chaise. Posez le bras sur la table. Ne croisez pas les jambes. Gardez les pieds au sol et tenez le dos bien droit.
- Se relaxer pendant 5 à 10 minutes avant de commencer les mesures.
- Lever le bras de sorte que le centre du brassard soit à la même hauteur que le cœur.
- Bouger le moins possible et rester calme pendant les mesures.
- Ne pas faire de mesure juste après un effort physique ou un bain. Se reposer pendant 20 à 30 minutes avant de faire les mesures.
- S'efforcer de mesurer la tension à la même heure tous les jours.

Mesure (Opération)

Pendant la mesure, il est normal que l'on sente que le brassard serre fortement le bras. Choisissez un mode de mesure (opération de l'appareil).

Mesure normal avec les données conservées:Appuyez sur le bouton **START**.

Rappel des données: Appuyez sur et tenez le bouton **START**.

Effacement des données: Enlever la pile et l'installer de nouveau.

Après la mesure

Après que la mesure soit achevée, enlever le brassard et enregistrer vos données et ensuite appuyer sur le bouton **START** pour éteindre l'appareil.

Remarque: Cet appareil est doté de la fonction de mise hors tension automatique, qui éteint un appareil automatiquement dans un délai d'une minute après la mesure. Attendez au moins trois minutes avant de remesurer votre tension (ou celle d'une autre personne) à des fins de confirmation.

La Mesure

Mesures avec l'enregistrement des données

1. Asseyez-vous confortablement en mettant le brassard au bras (gauche de préférence).
Asseyez-vous calme pendant la mesure.

2. Appuyez sur le bouton **START** (mise en marche).

□ Le bip sonne et la moyenne des pressions sanguines et la classification suivant l'OMS et les numéros des dernières données sont affichés brièvement.

□ Quand le "zéro" est en train de clignoter, l'appareil est prêt à la mesure. Si la marque **V** apparaît, le brassard contient encore de l'air. Appuyez sur le bouton de la valve de dégonflage jusqu'à ce que la marque **^** apparaisse.

3. Gonflez le brassard en pressant la poire en caoutchouc.

□ Un indicateur du progrès de la pression et la tension courante sont affichés.

□ Arrêtez de presser la poire en caoutchouc quand la marque **^** disparaît.

Note: Si vous voulez arrêter le gonflage à n'importe quel moment, arrêtez de bloquer la poire en caoutchouc et pousser la valve de dégonflage afin de chasser l'air du brassard.


4. Quand le gonflage est terminé, le dégonflage commence automatiquement et le bip sonne et le (♥) symbole des pulsations clignote, en indiquant que la mesure est en cours. Une fois que le pouls est détecté, la symbole clignote et le bip sonne avec chaque battement du pouls.

5. Quand la mesure est achevée, le bip sonne et la marque **V** est affichée. Les lectures des pressions systolique et diastolique et des pulsations sont affichées et enregistrées.

6. Appuyer sur le bouton de la valve de dégonflage pour chasser l'air complètement du brassard.

□ Quand une mesure se fait avec la pression insuffisante, la marque **^** apparaîtra. Re-gonflez le brassard vers une pression. Arrêtez de presser la poire en caoutchouc quand la marque **^** disparaît.

□ Quand une mesure se fait avec un pouls erratique ou dans un environnement très bruyant, **E r r** apparaîtra.

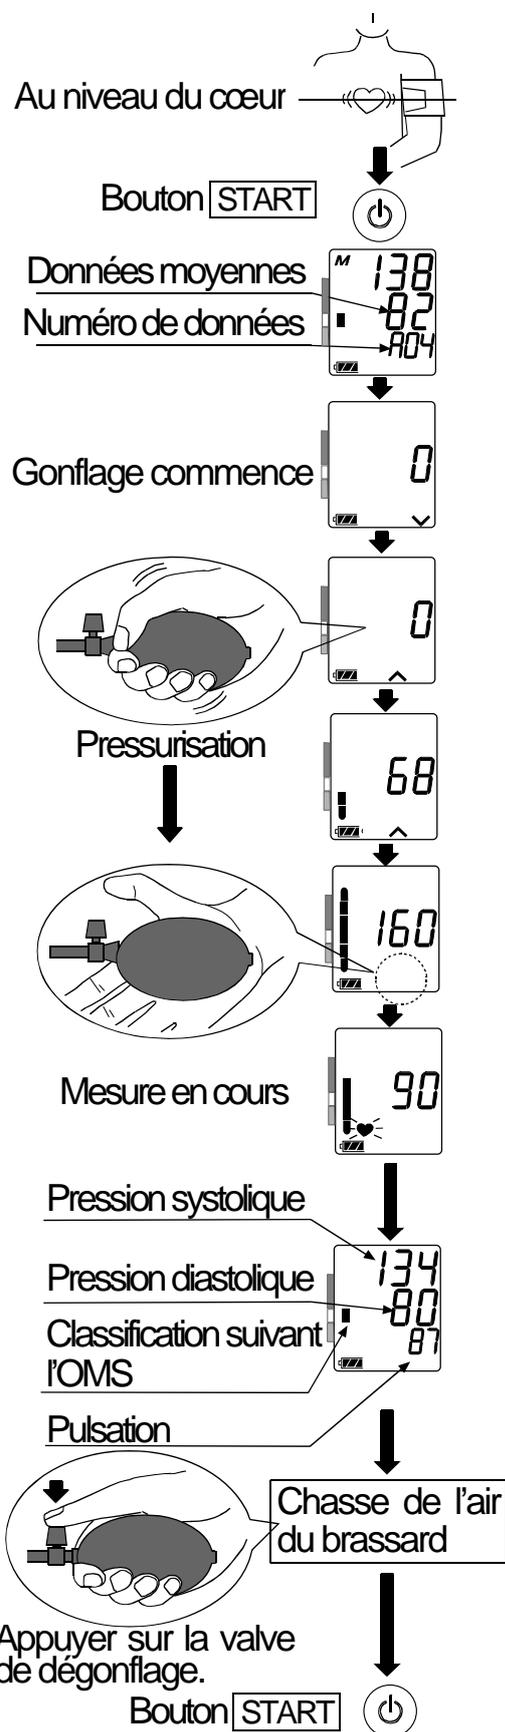

7. Eteindre l'appareil.

Appuyez sur le bouton **START** pour éteindre l'appareil. L'appareil sera en mode d'attente.

8. Mesures subséquentes

Si une mesure subséquente est demandée, éteignez l'appareil et allumez le de nouveau. Quand le "zéro" apparaît, l'appareil est prêt pour une autre mesure.

Note: Il faut compter au moins trois minutes entre plusieurs mesures sur la même personne.

9. Fonction d'arrêt automatique


Si l'appareil est laissé en marche après une mesure, il s'éteindra automatiquement après environ une minute. Il peut être éteint à n'importe quel moment en appuyant sur le bouton **START**.

Consignes et observations pour une mesure correcte

- Asseyez-vous confortablement. Placez le bras (gauche de préférence) sur une table ou un autre support de manière à ce que le centre du brassard soit à la même hauteur que le cœur.
- Détendez-vous pendant cinq à dix minutes avant de commencer la mesure. Si vous êtes énervés ou au contraire déprimés, cela se reflètera sur votre tension de même que sur votre pouls.
- Votre pression sanguine varie constamment, dépendant de ce que vous êtes en train de faire et de ce que vous avez mangé. D'autre part, certaines boissons ont un effet très fort et très rapide sur la tension artérielle.
- Cet appareil se réfère aux pulsations cardiaques pour mesurer la tension et le pouls. Par conséquent, si vos pulsations sont faibles ou irrégulières, l'appareil pourrait avoir des difficultés à mesurer votre tension artérielle.
- Si l'appareil détecte une condition qui est anormal, il arrêtera la mesure et affiche un symbole d'erreur. Référez-vous à la page 4 concernant les descriptions des symboles.
- Cet appareil de la pression sanguine est destiné à l'utilisation unique par des personnes adultes. Consulter avec votre médecin avant d'utiliser cet appareil pour la mesure de la pression sanguine d'un enfant. Un enfant ne doit pas utiliser cet appareil sans surveillance par des personnes adultes.

Mode Opérateur


- Mesures avec l'enregistrement des données** (Référez-vous à la page 8)
 Appuyez sur le bouton **START**. La pression sanguine est mesurée et les données sont conservées dans l'appareil. Cet appareil peut conserver les 30 dernières mesures en mémoire.
- Rappel des données en mémoire**
 Appuyez sur et tenez le bouton **START** pour rappeler les données. Les données conservées apparaissent automatiquement dans l'ordre des dernières données.
- Effacement des données**
 Enlever la pile afin d'effacer toutes les données et l'installer de nouveau.

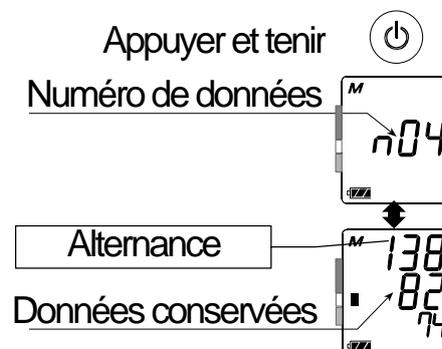

Indicateur de la Classification de la Pression Sanguine Suivant l'OMS

Chacun des 6 segments d'indicateur du progrès de la pression correspondent à la classification de la pression sanguine suivant l'OMS, décrit à la page suivante.


Indicateur de la Classification Suivant l'OMS

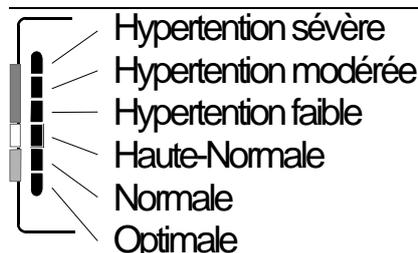

- : L'indicateur affiche un segment, basé sur les dernières données, correspondant à la classification suivant l'OMS.

Indicateur du Progrès de la Pression

L'indicateur suit le progrès de la pression pendant la mesure.

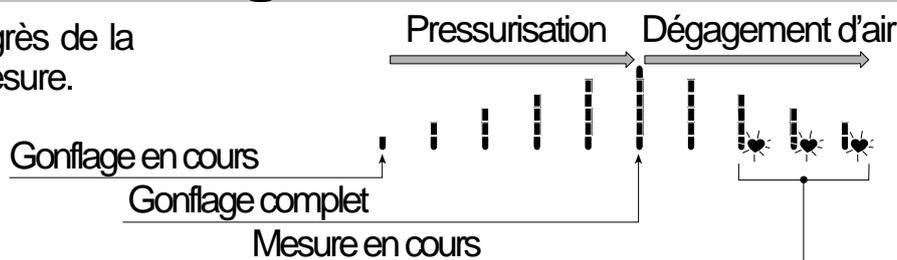

Qu'est-ce Qu'une Fréquence Cardiaque Irrégulière?

Le moniteur de la pression sanguine "Modèle UA-705" permet la mesure d'une pression sanguine et du pouls, même quand une pulsation cardiaque irrégulière se produit. Une pulsation cardiaque irrégulière est définie comme une pulsation du cœur qui dévie de 25 % de la moyenne de toutes les pulsations du cœur pendant la mesure de la pression sanguine. Il est important que vous vous détendiez, restiez calme et ne parliez pas pendant les mesures.

Note: *Si vous voyez fréquemment l'indicateur(♥), il est recommandé de contacter votre médecin afin de faire un diagnostic plus précis et de dépister un éventuel risque d'arythmie.*

Pression Sanguine

Qu'est-ce que la pression sanguine?

La pression sanguine est la force avec laquelle le sang vient frapper contre les parois des artères. La pression systolique se produit lorsque le cœur se contracte. La pression diastolique se produit lorsque le cœur se détend. La pression sanguine est mesurée en millimètre de mercure (mmHg). La pression sanguine naturelle d'un individu est représentée par la pression fondamentale qui est mesurée avant toute activité, le matin au lever du lit, et avant de manger ou de boire.

Qu'est-ce que l'hypertension et comment la contrôler?

L'hypertension est une tension artérielle (ou plus exactement une «pression sanguine») anormalement élevée. Non surveillée, l'hypertension peut provoquer de nombreux problèmes de santé, notamment une attaque d'apoplexie ou une crise cardiaque. L'hypertension peut être contrôlée en changeant son style de vie, en évitant tout stress et avec des médicaments sous la surveillance médicale. Pour empêcher l'hypertension ou la garder sous contrôle:


- Ne pas fumer
- Réduire sa consommation de sel et de graisse.
- Maintenir un poids adéquat.
- Faire régulièrement des exercices physiques.
- Effectuer régulièrement des visites médicales.

Comment mesurer la pression sanguine chez soi?

Lorsque la tension est mesurée à l'hôpital ou dans le cabinet du médecin, l'on ne parvient pas toujours à se décontracter, ce qui peut avoir pour effet de faire monter la tension de 25 à 30 mmHg plus élevée que la tension mesurée chez soi. Le fait de mesurer sa tension tranquillement chez soi réduit les influences extérieures sur la valeur de la tension, complète les mesures effectuées par le médecin et permet d'établir un relevé plus précis et plus complet de sa tension artérielle.

Classification de la pression sanguine suivant l'OMS

Les critères d'évaluation pour une haute pression sanguine, sans regarder l'âge, ont été établis par l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) comme indiqué dans le graphique.

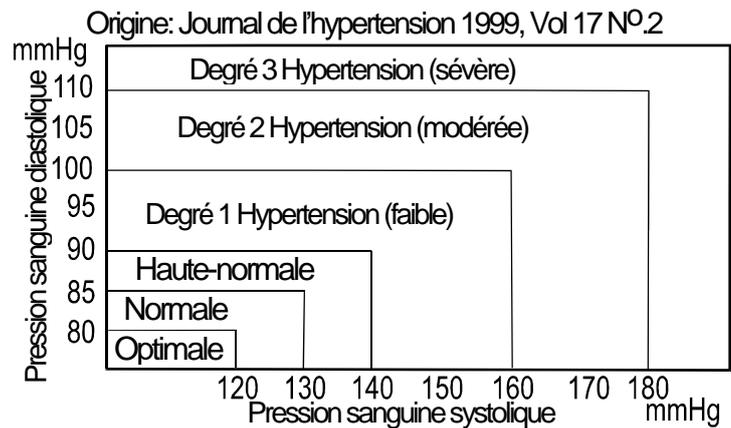


Variation de la pression sanguine

La tension artérielle (ou pression sanguine) d'un individu varie fortement selon le moment de la journée et selon la saison. Ainsi, elle peut varier de 30 à 50 mmHg dans une même journée selon un ensemble de conditions. Chez les personnes hypertendues, ces variations sont souvent encore plus prononcées. Normalement, la pression augmente pendant le travail ou le jeu et tombe à son plus bas niveau pendant le sommeil. Par conséquent ne pas trop s'inquiéter des résultats d'une seule mesure.

Mesurez votre tension tous les jours à la même heure (en suivant la procédure décrite dans ce manuel) pour connaître votre pression sanguine normale. Ces mesures quotidiennes vous permettront d'établir un relevé plus complet de votre tension.

Veillez à bien noter la date et l'heure lorsque vous enregistrez votre pression. Consultez votre médecin pour interpréter les données recueillies.

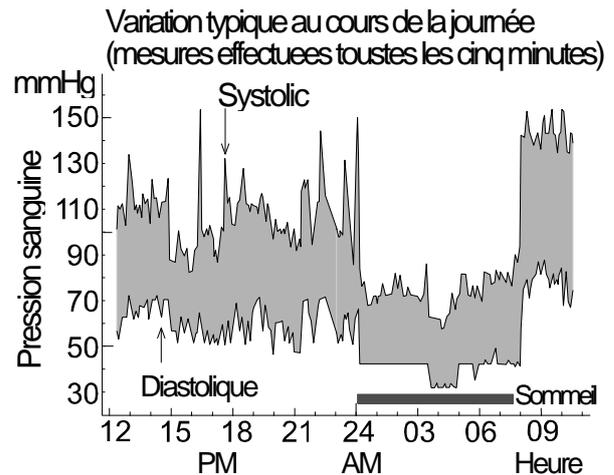

Recherche des Pannes

Problème	Cause probable	Actions correctives
Rien n'apparaît sur l'affichage, même lorsque l'on met l'appareil en marche.	La pile est épuisée.	Changer la pile par une neuve.
	La borne de la pile n'est pas dans le bon sens.	Installer la pile de nouveau avec les bornes négative et positive correspondant à celles indiquées dans le logement de la pile.
L'appareil ne prend pas les mesures. Les lectures sont trop hautes ou trop basses.	Le brassard est mal serré.	Serrer correctement le brassard.
	Vous avez bougé votre bras ou autre pendant la mesure.	Ne pas bouger et rester calme pendant la mesure.
	Le brassard est mal placé.	S'asseoir confortablement et ne pas bouger. Lever son bras de manière que le brassard soit au même niveau que le cœur.
	_____	Si votre pouls est faible ou irrégulier, l'appareil aura des difficultés à déterminer votre pression sanguine.
Autres	La valeur est différente de celle mesurée dans une clinique ou chez le médecin.	Voir le paragraphe 3. "Comment mesurer la pression sanguine chez soi ?".
	_____	Enlever la pile, et l'installer de nouveau correctement et effectuer la mesure encore une fois.

Note: Si les remèdes décrits ci-dessus ne suffisent pas pour résoudre les problèmes, contactez votre revendeur. N'essayez pas d'ouvrir ou réparer vous-même cet appareil, car n'importe quel essai de ce genre pourrait annuler votre garantie.

Entretien

Ne pas ouvrir l'appareil car il comporte des composants électriques sensibles et une unité d'air complexe qui pourraient être endommagés. Si vous n'arrivez pas à situer un problème avec le tableau de recherche de problèmes, demandez au service après-vente de votre revendeur ou du groupe de service A & D. Le groupe de service A & D vous fournira des informations techniques sur les fournisseurs agréés, les pièces et les unités de rechange.

Cet appareil a été dessiné et fabriqué pour une longue période de service. Mais il est généralement recommandé de le faire vérifier tous les 2 ans pour assurer le fonctionnement correct et la précision. Veuillez contacter votre revendeur autorisé ou le groupe de service A&D pour l'entretien.

Fiche Technique

Type	UA-705
Méthode de mesure	Mesure oscillométrique
Plage de mesure	Pression : de 20 à 280 mmHg Pouls : de 40 à 200 pulsations / minute
Précision de mesure	Pression : ± 3 mmHg Pouls : $\pm 5\%$
Consommation électrique	1 x 1,5 volts (R6P ou LR6 ou AA)
Nombre de mesures	Environ 4000 mesures, lorsque des piles alcalines AA sont utilisées, avec une valeur de tension de 180 mmHg à une température ambiante de 23 °C
Classification	Équipement à alimentation interne ME Mode de fonctionnement en continu
Test clinique	Conformément à ANSI / AAMI SP-10 1987
EMC	IEC 60601-1-2: 2007
Mémoire de données	Dernières 30 mesures.
Condition de fonctionnement	de +10°C à + 40°C (hum. rel. de 15 à 85%) de 800 hPa à 1060 hPa
Condition de stockage / Transport	de -10 °C à + 60°C (hum. rel. de 15 à 85%)
Dimensions	environ 81 [l] x 54 [h] x 105 [p] mm
Poids	environ 120 g sans la pile
Partie appliquée	Brassard Type BF 
Durée de vie utile	Appareil: 5 ans (six utilisations par jour) Brassard: 2 ans (six utilisations par jour)

Accessoires vendus séparément

Brassard	Numéro du catalogue	Taille du brassard	Arm Size
	CUF-D-LA	Brassard adulte de grande taille	32 cm to 45 cm
	CUF-D-A	Brassard adulte	22 cm to 32 cm

Taille du bras: La circonférence du biceps.

Note: Les spécifications pourront être changées en vue d'amélioration sans préavis.

EMC table information is listed on our website:

http://www.aandd.jp/products/manual/medical/emc_fr.pdf



A&D Company, Limited

Asahi 1-243, Kitamoto-shi, Saitama 364-8585, JAPAN
Telephone: [81] (48) 593-1111 Fax: [81] (48) 593-1119

EC REP A&D INSTRUMENTS LIMITED

Unit 24/26 Blacklands Way, Abingdon Business Park, Abingdon, Oxfordshire
OX14 1DY United Kingdom
Telephone: [44] (1235) 550420 Fax: [44] (1235) 550485

A&D ENGINEERING, INC.

1756 Automation Parkway, San Jose, California 95131, U.S.A.
Telephone: [1] (408) 263-5333 Fax: [1] (408) 263-0119

A&D AUSTRALASIA PTY LTD

32 Dew Street, Thebarton, South Australia 5031, AUSTRALIA
Telephone: [61] (8) 8301-8100 Fax: [61] (8) 8352-7409